

Schalldämmgehäuse

Die folgenden Informationen sind eine Ergänzung zur Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes.

Grundsätzlich ist zusätzlich die Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes zu beachten, in der wichtige Informationen wie z. B. Sicherheitshinweise, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Desinfektion, Reinigung, etc. beschrieben sind.



Nur ausgebildete Fachkräfte oder von Dürr Dental geschultes Personal dürfen das Gerät aufstellen, installieren und in Betrieb nehmen.

Lieferumfang

Folgende Artikel sind im Lieferumfang enthalten (Abweichungen durch länderspezifische Vorschriften und Einfuhrbestimmungen möglich):

Schalldämmgehäuse 7122200000

– Schalldämmgehäuse

– Ansaugrohr

– Einbaurahmen für Anzeigemodul

– Montagehinweis


Zubehör

Folgende Artikel sind notwendig für den Betrieb des Gerätes, abhängig von der Anwendung:


Kondensatsabscheiderkit für Gehäuse 7119-701-20




1 Schalldämmgehäuse öffnen

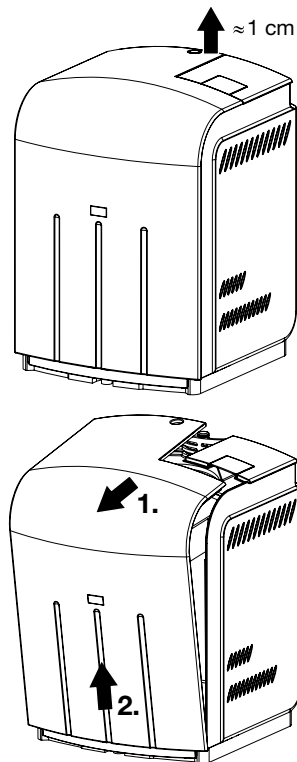


2 V 300 S






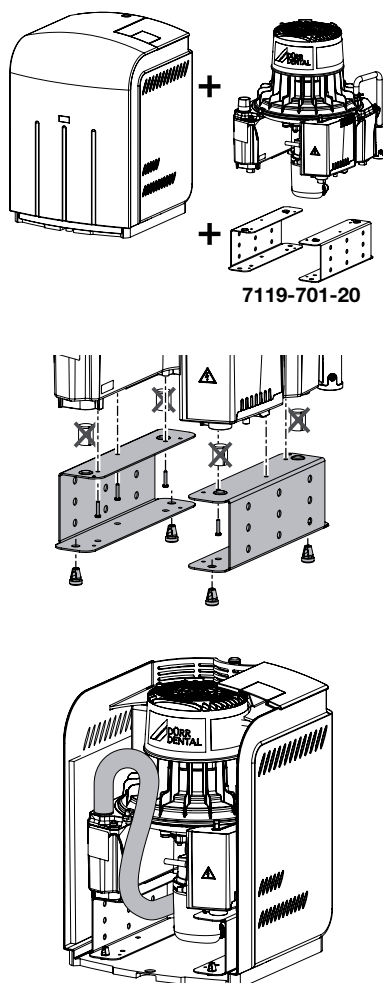


3 VS 300 S


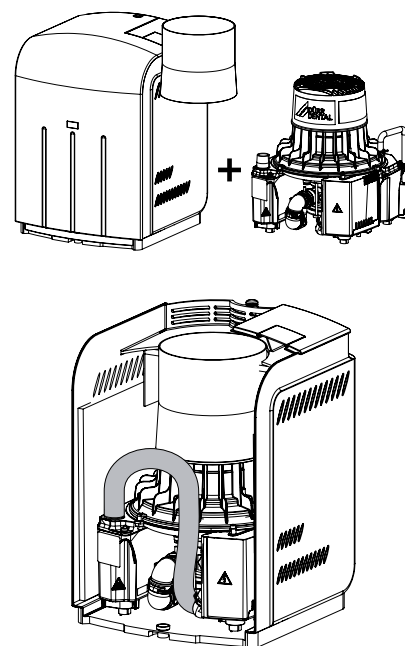


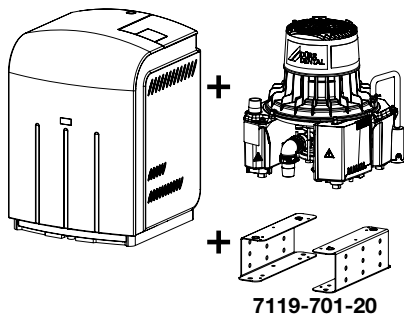



4 Anzeigemodul

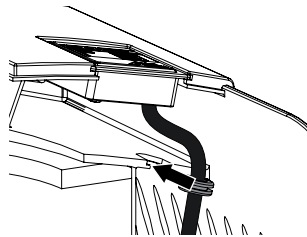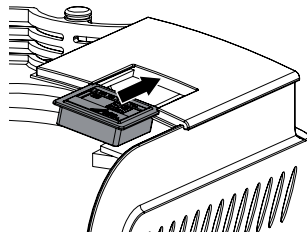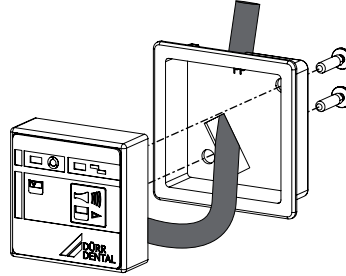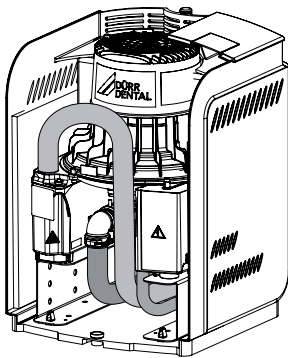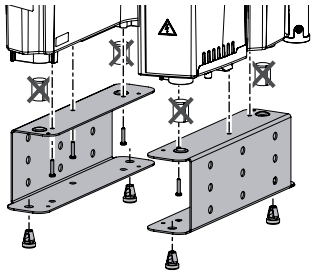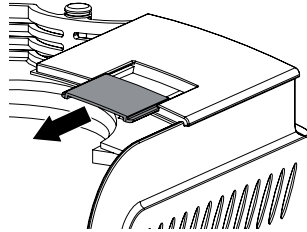

5 VSA 300 S

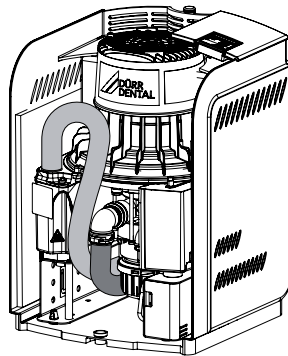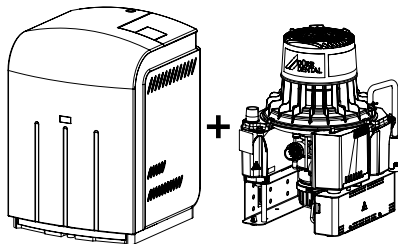

6 CA 4

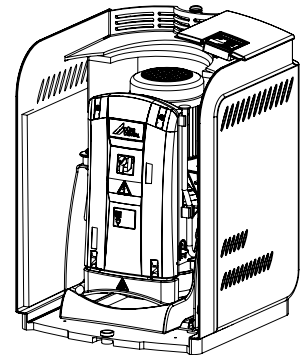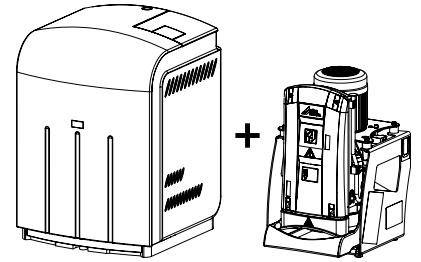

7 Schalldämmgehäuse schließen

