

VistaPano S / VistaPano S Ceph

Die folgenden Informationen sind eine Ergänzung zur Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes.


Grundsätzlich ist zusätzlich die Montage- und Gebrauchsanweisung des Gerätes zu beachten, in der wichtige Informationen wie z.B. Sicherheitshinweise, Aufstellung, elektrischer Anschluss, Desinfektion, Reinigung, etc. beschrieben sind.




Hersteller/Manufacturer:
VATECH Co. Ltd.

Pano


Gerät vorbereiten

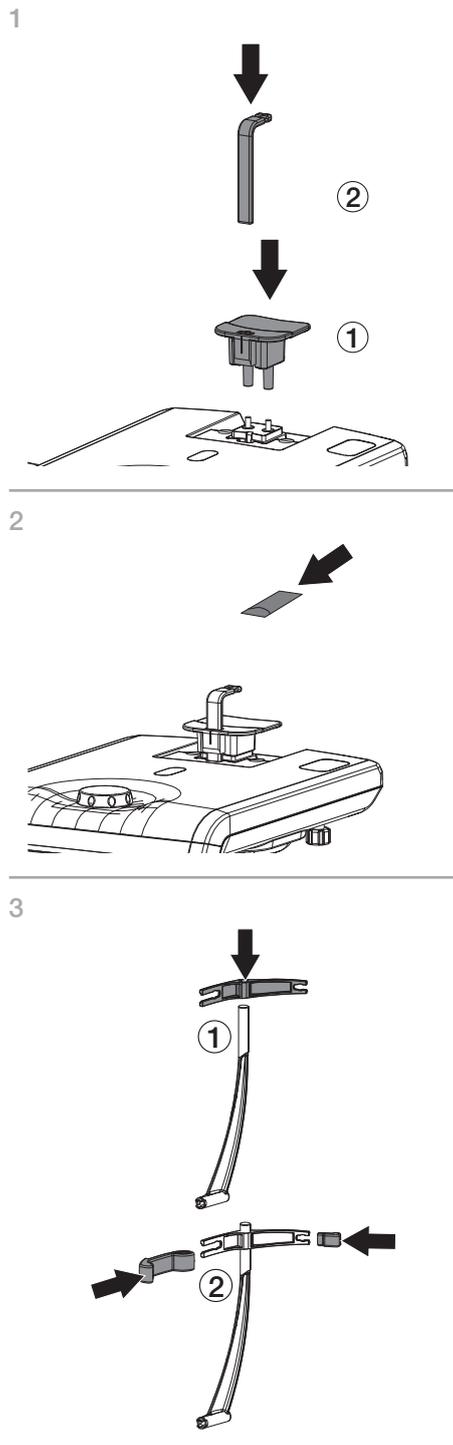


Imaging-Software einstellen

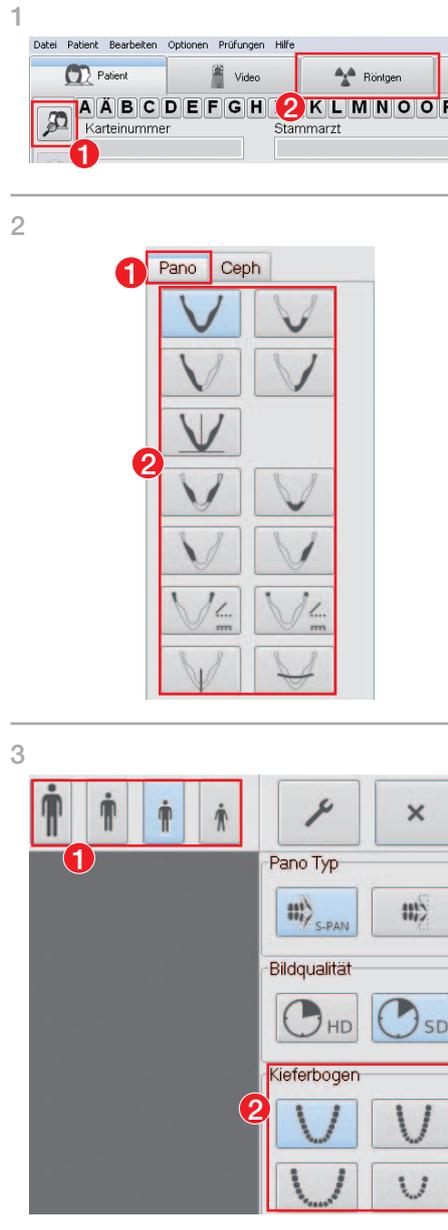

4

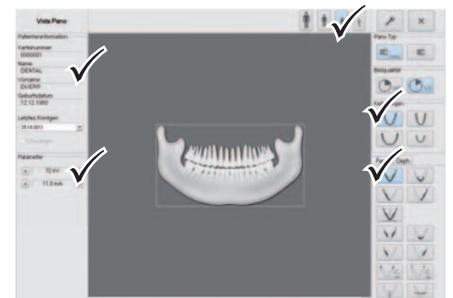

Patient am Gerät positionieren

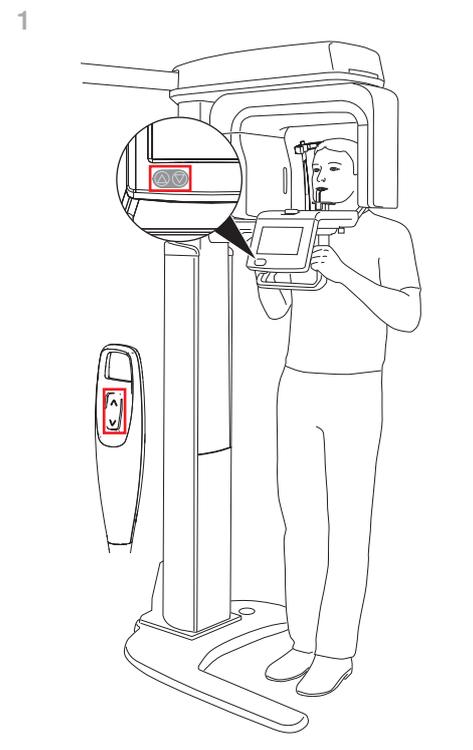

Vertreiber/Distributor:

DÜRR DENTAL SE
Höpfheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany


2207100049L01




1812V005




2




3

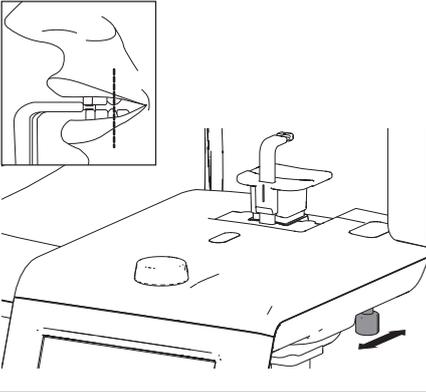


4

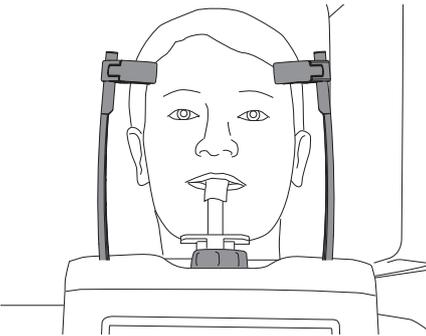

5

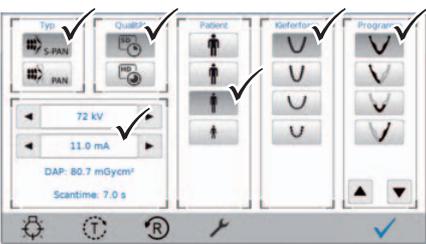


6

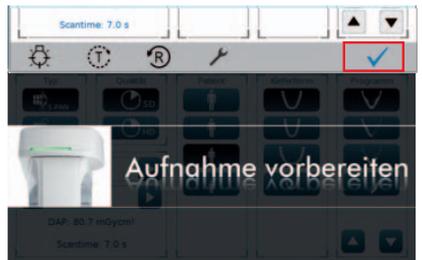


7


others

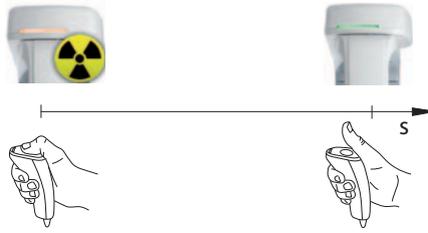

bitewing

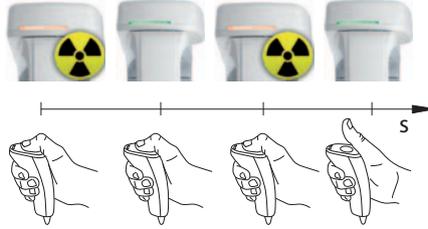


8

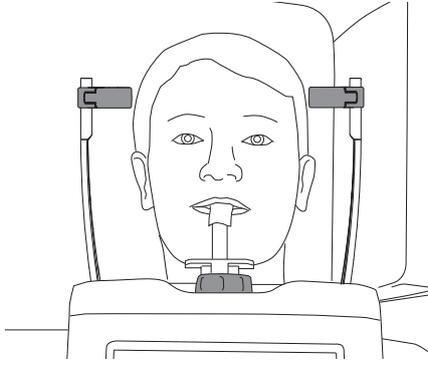


Aufnahme speichern

1

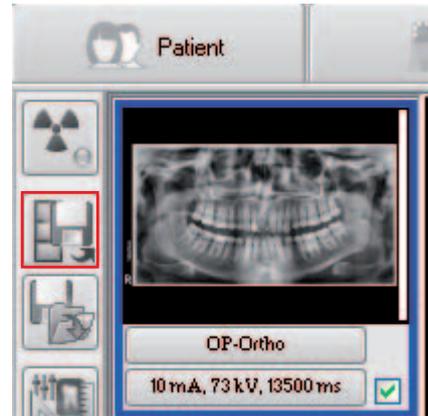


2

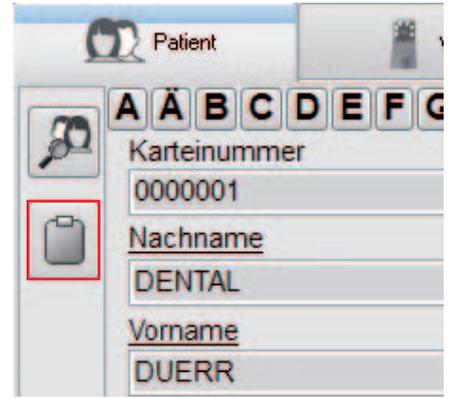


Desinfizieren

1

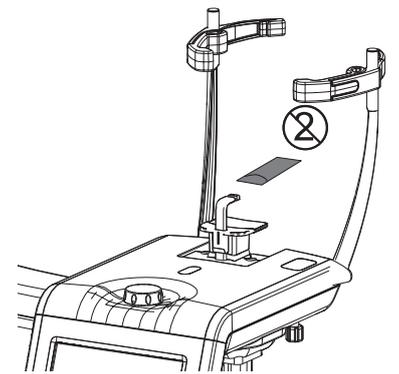

2






Dampfsterilisieren

1






Ceph






Gerät vorbereiten

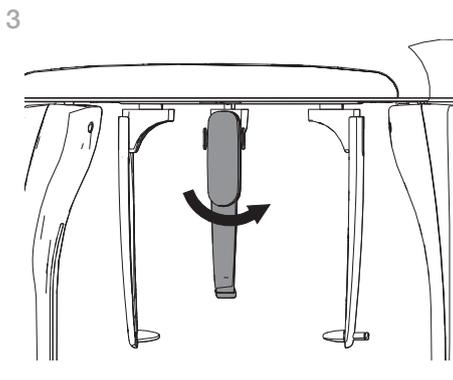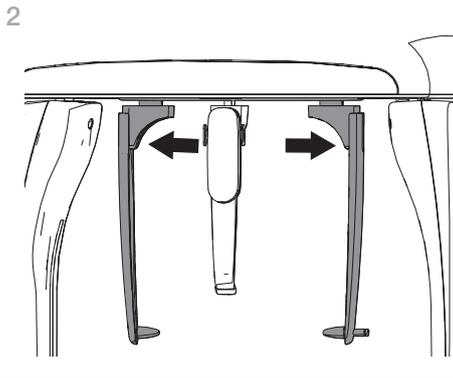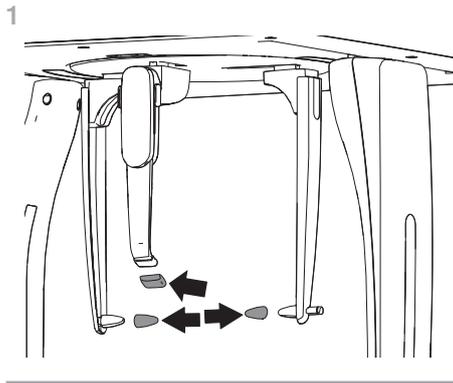


Imaging-Software einstellen

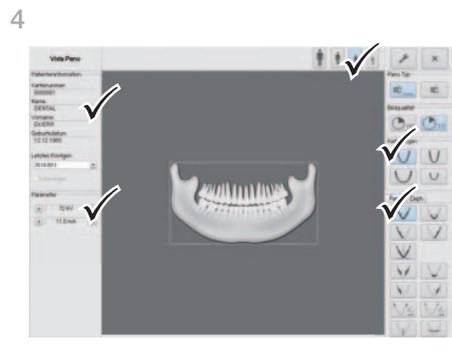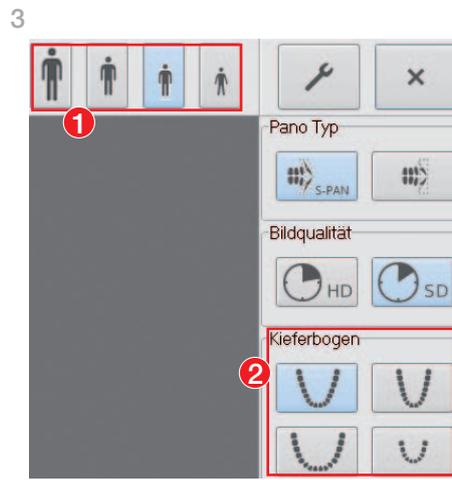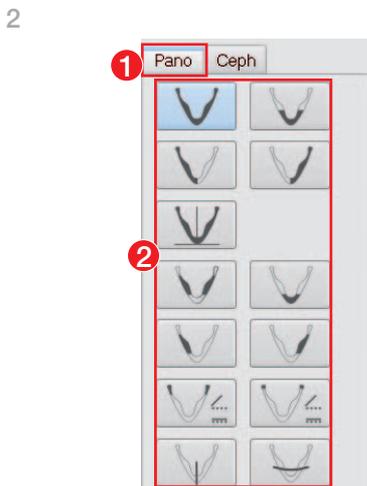


Patient am Gerät positionieren

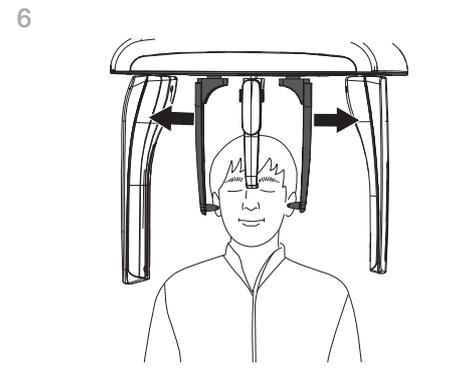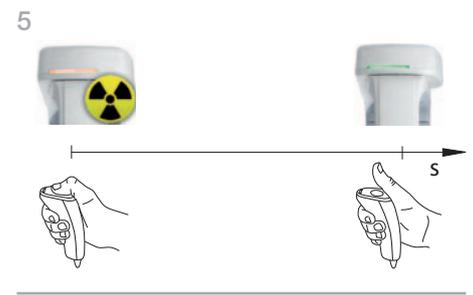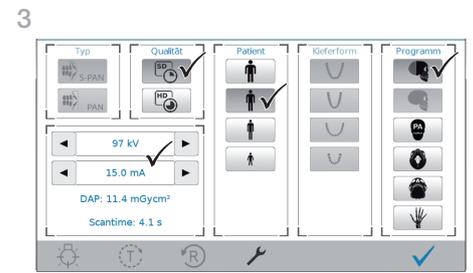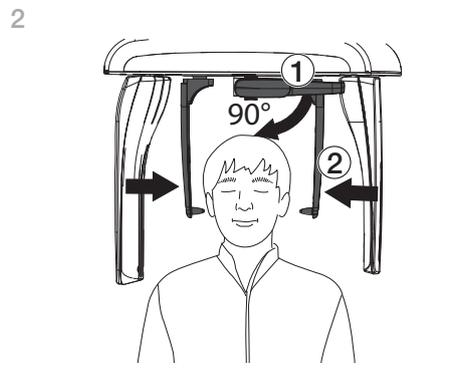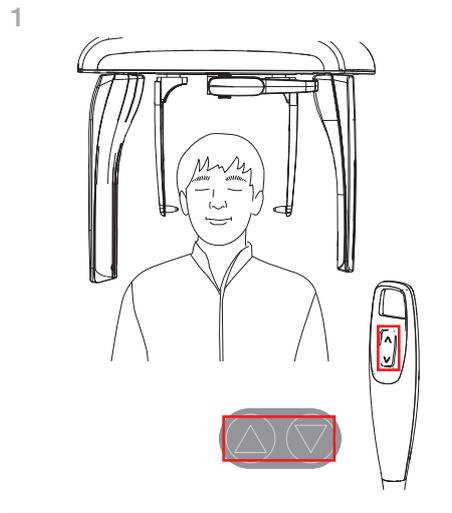

Aufnahme speichern

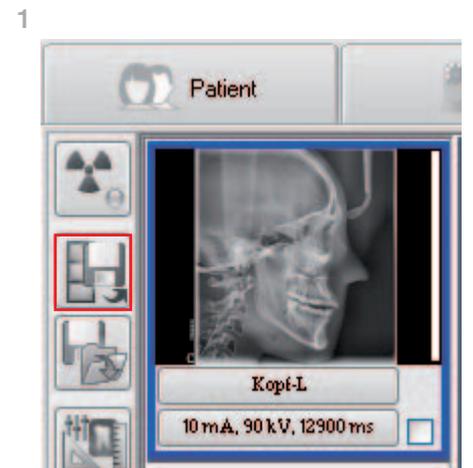


2

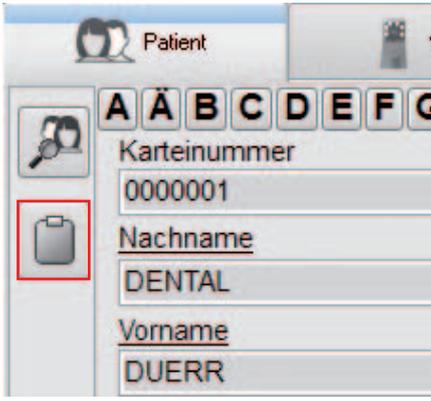

Desinfizieren

1

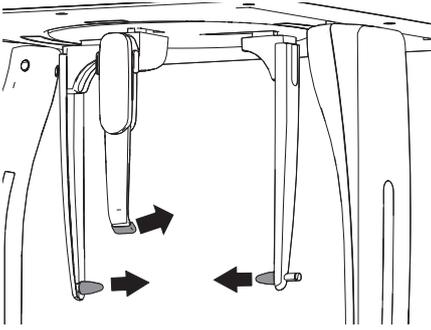

2

