
VistaRay Soporte de sensor

CENTRATORI PER SENSORE VISTARAY



Técnica del ángulo recto/en paralelo • Tecnica parallela/ad angolo retto



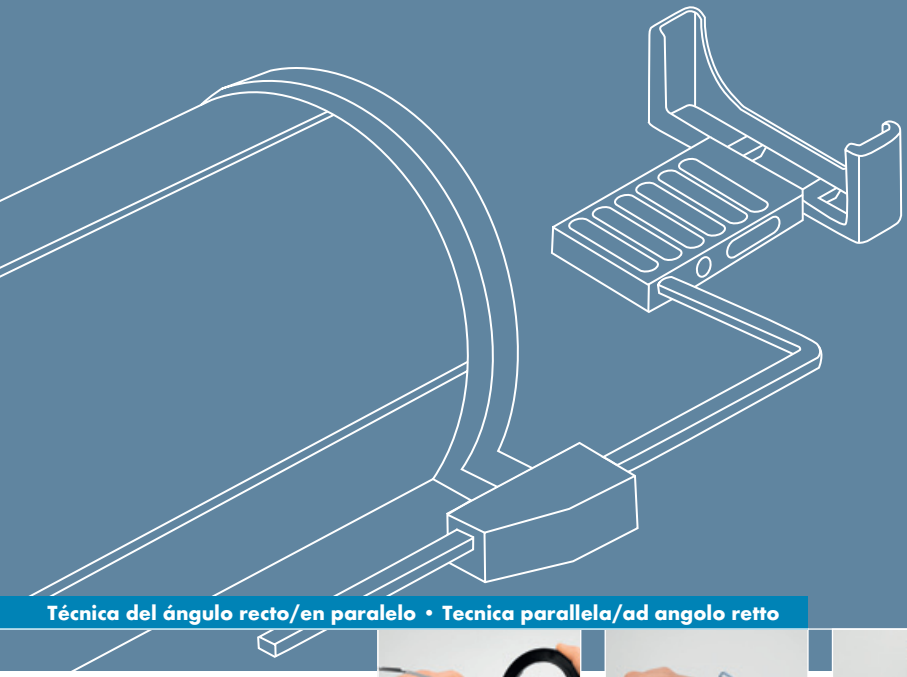



Instrucciones de uso resumidas / ES

Brevi istruzioni / IT

DÜRR DENTAL

Componentes del soporte de sensor

COMPONENTI DEL CENTRATORE

Guías: *esterilizables*
Bracci indicatori: *sterilizzabili*



Guía universal
Braccio indicatore universale
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-02



Guía universal
Braccio indicatore universale
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-02



Guía para aplicaciones endodónticas
Braccio indicatore endo
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-04



Guía para bitewing
Braccio indicatore bitewing
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-03

Anillos visores: *desinfección con spray desinfectante*
Anelli centratori: *autoclavabili e termodisinfettabili*



Anillo visor Duo, anterior/posterior/aplicaciones endodónticas
Anello centratore Duo anteriori/posteriori/endo 1 ud./ref., 1 pz./codice
2121-981-22



Anillo visor Duo, anterior/posterior/aplicaciones endodónticas
Anello centratore Duo anteriori/posteriori/endo 1 ud./ref., 1 pz./codice
2121-981-22



Anillo visor Duo, anterior/posterior/aplicaciones endodónticas
Anello centratore Duo anteriori/posteriori/endo 1 ud./ref., 1 pz./codice
2121-981-22



Anillo visor IPL para bitewing
Anello centratore IPL bitewing
1 ud./ref., 1 pz./codice
2121-981-23



Bloque de mordida, anterior
Bite block anteriori
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-71



Bloque de mordida, posterior
Bite block posteriori
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-72



Bloque de mordida, kit para aplicaciones endodónticas
Bite block endo (1 x lato sinistro, 1 x lato destro) 2 uds./ref., 2 pz./codice
2121-981-74



Bloque de mordida bitewing *Bite block bitewing*
4 uds./ref., 4 pz./codice **2121-981-73**



Carro portacables (clip para la fijación del cable del sensor a la guía)
Clip fermacavo (per fissare il cavo del sensore al braccio indicatore)
4 uds./ref., 4 pz./codice **2121-981-31**

Las imágenes mostradas no reproducen el tamaño real.
Fig. non in scala

Montaje de los componentes del soporte de sensor

ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI DEL CENTRATORE PER SENSORE



1. Radiografías en la región anterior

Per riprese nel settore anteriore




2. Radiografías en la región posterior

Per riprese nel settore posteriore



3. Radiografías de medición para endodoncias

Per radiografie endometriche nei trattamenti dei canali radicolari

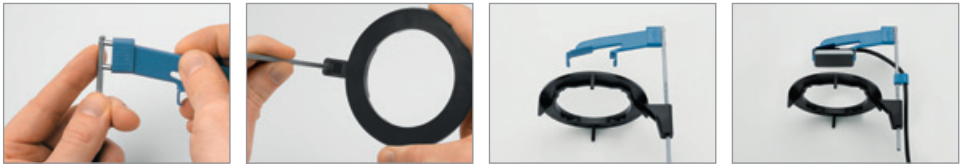

4. Radiografías bitewing

Per riprese bitewing

Componentes del soporte de sensor

COMPONENTI DEL CENTRATORE

Guías: *esterilizables*
Bracci indicatori: *sterilizzabili*



Guía universal
Braccio indicatore universale
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-02



Guía universal
Braccio indicatore universale
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-02



Guía para aplicaciones endodónticas
Braccio indicatore endo
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-04



Guía para bitewing
Braccio indicatore bitewing
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-03

Anillos visores con pantalla de plomo y ventana: *pueden desinfectarse frotando (opcional)*
Anelli centratori in piombo con finestra: *disinfettabili per strofinamento (optional)*



Anillo visor con pantalla de plomo, 2x3 anterior
Anello centratore in piombo con finestra, anteriori
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130100038



Anillo visor con pantalla de plomo, posterior
Anello centratore in piombo con finestra, posteriori
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-26



Anillo visor con pantalla de plomo para 2x3 endodoncia
Anello centratore in piombo con finestra, endo
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130100038



Anillo visor con pantalla de plomo para bitewing
Anello centratore in piombo con finestra, bitewing
1 ud./ref., 1 pz./codice
2130-981-24



Bloque de mordida, anterior
Bite block anteriori
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-71



Bloque de mordida, posterior
Bite block posteriori
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-72



Bloque de mordida, kit para aplicaciones endodónticas
Bite block endo (1 x lato sinistro, 1 x lato destro)
2 uds./ref., 2 pz./codice
2121-981-74



Bloque de mordida
Bite block bitewing
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-73



Carro portacables (clip para la fijación del cable del sensor a la guía)
Clip fermacavo (per fissare il cavo del sensore al braccio indicatore)
4 uds./ref., 4 pz./codice
2121-981-31

Las imágenes mostradas no reproducen el tamaño real.
Fig. non in scala

Montaje de los componentes del soporte de sensor

ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI DEL CENTRATORE






1. **Radiografías en la región anterior**
   Per riprese nel settore anteriore






2. **Radiografías en la región posterior**
   Per riprese nel settore posteriore


3. **Radiografías de medición para endodoncias**
   Per radiografie endometriche nei trattamenti dei canali radicolari


4. **Radiografías bitewing**
   Per riprese bitewing

Pie de imprenta
Todos los derechos reservados, especialmente el derecho de reproducción, distribución y traducción. No se autoriza la reproducción de ninguna parte de esta guía en ninguna forma (fotocopia, microfilm o cualquier otro proceso) sin la autorización escrita de la empresa Kentzler-Kaschner Dental GmbH, ni la copia, edición, reproducción o distribución en soportes electrónicos.

Note legali
Tutti i diritti riservati, soprattutto i diritti di riproduzione, distribuzione e traduzione. La riproduzione, l'elaborazione, la distribuzione e la memorizzazione, anche parziali, delle presenti linee guida con qualsiasi mezzo (fotocopie, microfilm o altro mezzo) o mediante l'impiego di sistemi elettronici sono vietate senza la preventiva autorizzazione scritta di Kentzler-Kaschner Dental GmbH.

Kentzler-Kaschner Dental GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen
Germany

CE 0483

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany

www.duerrdental.com
info@duerr.de

9000-618-140/05_2017_02
La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas
Technical modifications reserved